

一般用検査薬

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

\*\*2024年10月改訂  
\*2021年2月改訂  
認証番号 227AAEZ00044000

一般用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット

# ドゥーテスト<sup>®</sup>・hCGα 妊娠検査薬

自分で、簡単・正確、チェック

## 妊娠の早期発見の重要性

妊娠初期は胎児の脳や心臓などの諸器官が形成されるとも重要な時期であり、胎児が外からの影響を受けやすい時期でもあります。したがって、妊娠しているかどうかをできるだけ早く知り、栄養摂取や薬の使用に十分気をつけるとともに、飲酒、喫煙、風疹などの感染症や放射線照射などを避けることが、胎児の健全な発育と母体の健康のためにとっても大切なことです。

## 妊娠がわかるしくみ（検査の原理）

妊娠すると、hCGと呼ばれるヒト絨毛性性腺刺激ホルモンが体内でつくられ、尿中に排泄されるようになります。ドゥーテスト・hCGαは金コロイドクロマト免疫測定法によって、この尿中のhCGを検出する妊娠検査用キットです。この検査薬は妊娠しているかどうかを補助的に検査するものであり、妊娠の確定診断を行うものではありません。

## 使用上の注意

### ❌してはいけないこと

- 検査結果から、自分で妊娠の確定診断をしないでください。
  - ・判定が陽性であれば妊娠している可能性があります。正常な妊娠かどうかまで判別できませんので、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
  - ・妊娠の確定診断とは、医師が問診や超音波検査などの結果から総合的に妊娠の成立を診断することです。

### 🗣️相談すること

1. 不妊治療を受けている人は使用前に医師にご相談ください。
2. 判定が陰性であっても、その後生理が始まらない場合には、再検査をするか、または医師にご相談ください。

### 検査時期に関する注意

1. 生理周期が順調な場合  
生理予定日のおおむね1週間後から検査ができます。しかし妊娠の初期では、人によってはまれにhCGがごく少ないこともあり、陰性や不明瞭な結果を示すことがあります。このような結果がでてから、およそ1週間たってまだ生理が始まらない場合には、再検査をするか、または医師にご相談ください。
2. 生理周期が不規則な場合  
前回の周期を基準にして予定日を求め、おおむねその1週間後に検査してください。結果が陰性でもその後生理が始まらない場合には、再検査をするか、または医師にご相談ください。

### その他の注意

使用後のテストスティックは、プラスチックゴミとして各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。

## 使用目的

尿中のヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（hCG）の検出（妊娠の検査）

## 使用方法


- 検査ができる時期  
生理予定日のおおむね1週間後から検査できます。  
また、朝、昼、夜、どの時間帯の尿でも検査できます。

## \* 検査のしかた

朝、昼、夜、どの時間帯の尿でも検査できます。

### 検査の手順

個包装を検査直前に開封し  
テストスティックを取り出してください。

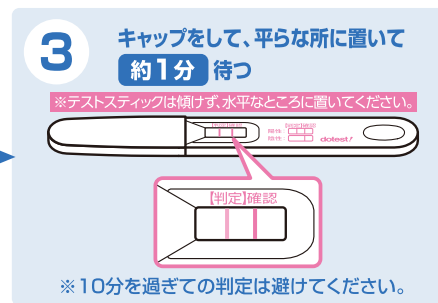

## \* 判定のしかた

スティック窓の確認部分にラインが出ていることを確認してください。（薄くても確認部分にラインが出れば正しく検査できています）

### 陽性

【判定】部分に赤紫色の縦のラインが出たとき  
（薄くても判定部分に縦のラインが現れたら陽性です）



### 妊娠反応あり

妊娠の反応が認められました。  
妊娠している可能性があります。  
できるだけ早く医師の診断を受けてください。

### 陰性

【判定】部分に赤紫色の縦のラインが出なかつたとき



### 妊娠反応なし

今回の検査では妊娠反応は認められませんでした。しかし、その後生理が始まらない場合は、再検査をするかまたは医師に相談してください。

# ドゥーテスト® 妊娠検査薬

使用に際して、次のことに注意してください。

## 採尿に関する注意

にごりのひどい尿や異物が混じった尿は、使用しないでください。

## 検査手順に関する注意

- ・操作は定められた手順に従って正しく行ってください。
- ・採尿後は、速やかに検査を行ってください。尿を長く放置すると検査結果が変わってることがあります。

## 判定に関する注意

- ・妊娠以外にも、次のような場合、結果が陽性となることがあります。
  - \* 閉経期の場合
  - \* hCG産生腫瘍の場合(絨毛上皮腫など)
  - \* 性腺刺激ホルモン剤などの投与を受けている場合
- ・予定した生理がないときでも、次のような場合、結果が陰性となることがあります。
  - \* 生理の周期が不規則な場合
  - \* 使用者の思い違いにより日数計算を間違えた場合
  - \* 妊娠の初期で尿中hCG量が充分でない場合
  - \* 異常妊娠の場合(子宮外妊娠など)
  - \* 胎児異常の場合(胎内死亡、けい留流産など)
  - \* 胞状奇胎などにより大量のhCGが分泌された場合など

## キットの内容・成分・分量・検出感度

【内容】1回用:テストスティック1本 2回用:テストスティック2本  
 【成分・分量】(テストスティック1本中)  
 抗hCG・モノクローナル抗体(マウス)液...1μL  
 金コロイド標識抗hCG・モノクローナル抗体(マウス)液...33μL  
 【検出感度】50IU/L

## 保管及び取り扱い上の注意

- ・小児の手の届かない所に保管してください。
- ・直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ・使用直前までテストスティックの袋は開封しないでください。
- ・使用期限の過ぎたものは使用しないでください。

## 保管方法・有効期間

室温保管 25ヶ月(使用期限は外箱およびテストスティックの袋に記載)

## 包装単位

1回用、2回用

## よくある質問

### Q1 【判定】部分に一時的に横のライン(色)が現れたのですが…?

A1 尿が吸いあがる過程で、試薬粒子の流れが横ライン状に見えたり、色がついて見えることがありますが、これは判定とは関係ありません。

### Q2 確認部分にラインが出なかったのですが…?

A2 確認部分にラインが出なかった場合は、尿量が極端に少なかったもしくは極端に多かったか、操作が不適切であった等のために、検査が正しく行われなかったと考えられます。その場合は、新しいテストスティックで再検査してください。

### Q3 確認部分のラインがすごく薄いのですが、検査はできていますでしょうか…?

A3 確認部分にたとえ薄くても線が発色している場合、正しく検査ができています。  
 【判定】部分にラインが濃く出ている場合、確認部分の線の発色が薄くなる場合がありますが、色の濃さに関係なくたとえ薄くても確認部分にラインが出ていれば正しく検査できています。

### Q4 検査の結果は陰性だったのに、その後も生理が始まらないのですが…?

A4 ドゥーテスト・hCGalは生理予定日のおおむね1週間後から検査可能です。しかし、予定日の思い違いや生理周期の変動などにより、結果的に検査時期が早すぎると、妊娠しているも尿中のhCGが検出可能濃度に達していない可能性があります。妊娠している場合、hCGの濃度は日ごとに高くなりますので、数日後に再検査するかまたは医師にご相談ください。

### Q5 薬の服用や飲酒は判定に影響するのでしょうか…?

A5 薬(かぜ薬、ピル等)の服用や飲酒による影響はありません。ただし、不妊治療などでhCGを含んだ性腺刺激ホルモン剤の投与を受けている場合は影響を及ぼすことがあります。

### Q6 【判定】部分にラインがあるのかわからないか、はっきり分らないのですが…?

A6 確認部分に線が発色している場合、色の濃さに関係なくたとえ薄い線でも【判定】部分にラインがでていれば陽性と判定してください。ただし、10分を過ぎての判定は避けてください。

### Q7 1~3分後は陰性だったのですが、10分以上経って【判定】部分にラインがでてきましたが…?

A7 今回は陰性です。10分を過ぎての判定は避けてください。しかし今後も生理が始まらないようなら、数日後に再検査するか医師にご相談ください。


### Q8 尿はどのくらいかけたらいいですか…?

A8 尿をスティックに直接かける場合は、約2秒です。尿量が多すぎると正しく検査ができない場合もありますので、5秒以上はかけないでください。紙コップ等を使用して検査する場合は、採尿部全体が浸るように2秒以上つけます。ただしこちらも5秒以上はつけないでください。


## Testing Period

Test the 「dotest」 as early as the 7th day of your missed period. You can test the 「dotest」 anytime of the day.

## Instruction For Use



Urinate

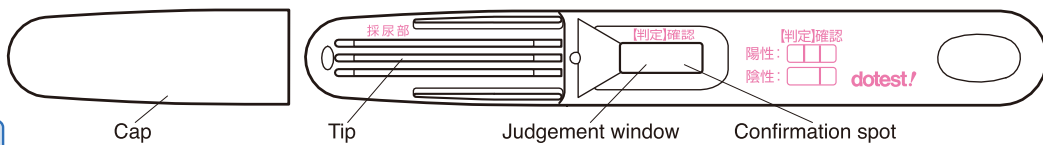

Wait



Read

- ① Urinate thoroughly on the Tip.(For about 2 seconds.)
- ② Cover the tip with the cap, keeping it closed.
- ③ Wait about 1 minute, and check that a red line has appeared on the Confirmation spot.

- ◆Judgement
- Positive(Pregnant): Red line in the Judgement window under 【判定】 will appear, including faint line . There is a possibility that you are pregnant. Please consult a doctor as soon as possible.
  - Negative(Not Pregnant):No red line in the Judgement window under 【判定】 . You may not be pregnant this time. If you have no menstruation afterward, please re-test or consult a doctor.



## お問合せ先

製品についてご意見やご要望、お困りごとやお悩みごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。女性スタッフが丁寧にさせていただきます。

コミュニケーションコール(お客様相談室)  
**0120-373-610**

受付時間  
 9:00~17:00  
 (土、日、祝除く)

**ロート製薬株式会社**  
 大阪市生野区巽西1-8-1